

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、下記の検査項目につきまして、検査内容を変更致しますので取り急ぎご案内致します。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目

- 1560 農薬スクリーニング
- 3566 プレセプシン

変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
1560	農薬スクリーニング	検査対象農薬	別掲参照(22 成分)	別掲参照(37 成分)	検査対象農薬の見直し
3566	プレセプシン	基 準 値	敗血症(細菌性)診断のカットオフ値 500 pg/mL	314 pg/mL 未満 (敗血症診断のカットオフ値 500 pg/mL)	全自動分析装置用試薬の採用
		報 告 下 限	50.0 pg/mL 未満	20.0 pg/mL 未満	

実施期日

- 平成 29 年 9 月 30 日(土)受付分より

農薬スクリーニング

農薬スクリーニングの検査対象農薬を下記のように37成分から22成分に変更致します。なお、分析対象から除外する成分は登録が失効している農薬であり、外部委託先 LSI メディエンス社での確認において事故事例は報告されておりません。また、来年4月には、検査法を GC-MS から LC-MS/MS への変更を予定しております。詳細につきましては、後日改めてご案内致します。

農薬分析対象薬


新	旧
スマチオン(MEP)	スマチオン(MEP)
マラチオン	マラチオン
CYAP	サリチオン
エチルチオメトン	CYAP
EPN	チオメトン
ダイアジノン	エチルチオメトン
MPP	EPN
メチダチオン(DMTP)	ダイアジノン
イソキサチオン	MPP
ピリミホスメチル	CYP
DDVP	パラチオン
トリクロルフォン(DEP)	メチダチオン(DMTP)
フェンバレート	イソキサチオン
シペルメトリン	ピリミホスメチル
ペルメトリン	DDVP
メトリブジン	トリクロルフォン(DEP)
シマジン(CAT)	α-ベンゾエピン
フェノブカルブ(BPMC)	γ-BHC
カルバリル(NAC)	ディルドリン
メソミル	アルドリン
アラクロール	エンドリン
プロパニル(DCPA)	ニトロフェン
	クロルデン
	DDT
	DDD
	DDE
	フェンバレート
	シペルメトリン
	ペルメトリン
	メトリブジン
	シマジン(CAT)
	フェノブカルブ(BPMC)
	カルバリル(NAC)
	メソミル
	アラクロール
	プロパニル(DCPA)
	PCP(ペンタクロルフェノール)

※赤文字は分析対象から削除。

プレセプシン

プレセプシンの測定試薬を全自動分析装置用試薬に変更致します。本変更に伴い、基準値を敗血症(細菌性)診断のカットオフ値に変更致します。

新旧二法の相関

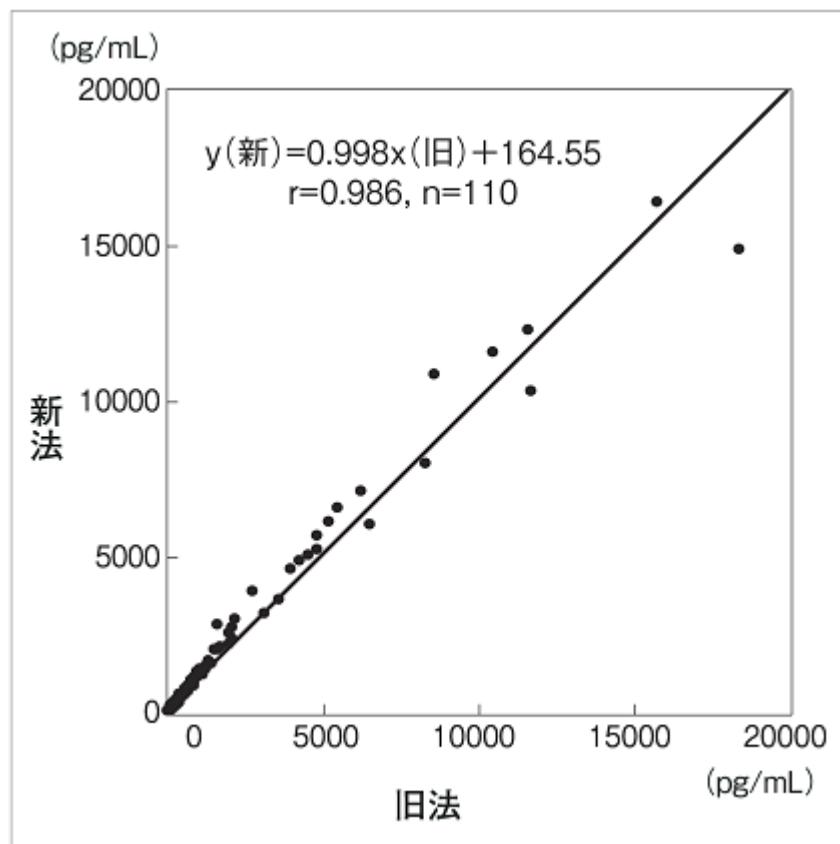

(LSI メディエンス検討データ)