

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、下記の検査項目につきまして、外部委託から自検化へ変更致しますので取り急ぎご案内致します。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記


### 対象項目/変更内容

項目コード	検査項目名	外注先	変更内容
0025	FDP 定量(P)	札幌臨床検査センター(株)	自 検 化

\*相関も良好で、基準値等変更はございません。  
裏面参照下さい。

### 変更期日

- 平成 31 年 5 月 1 日(水)受付日分より

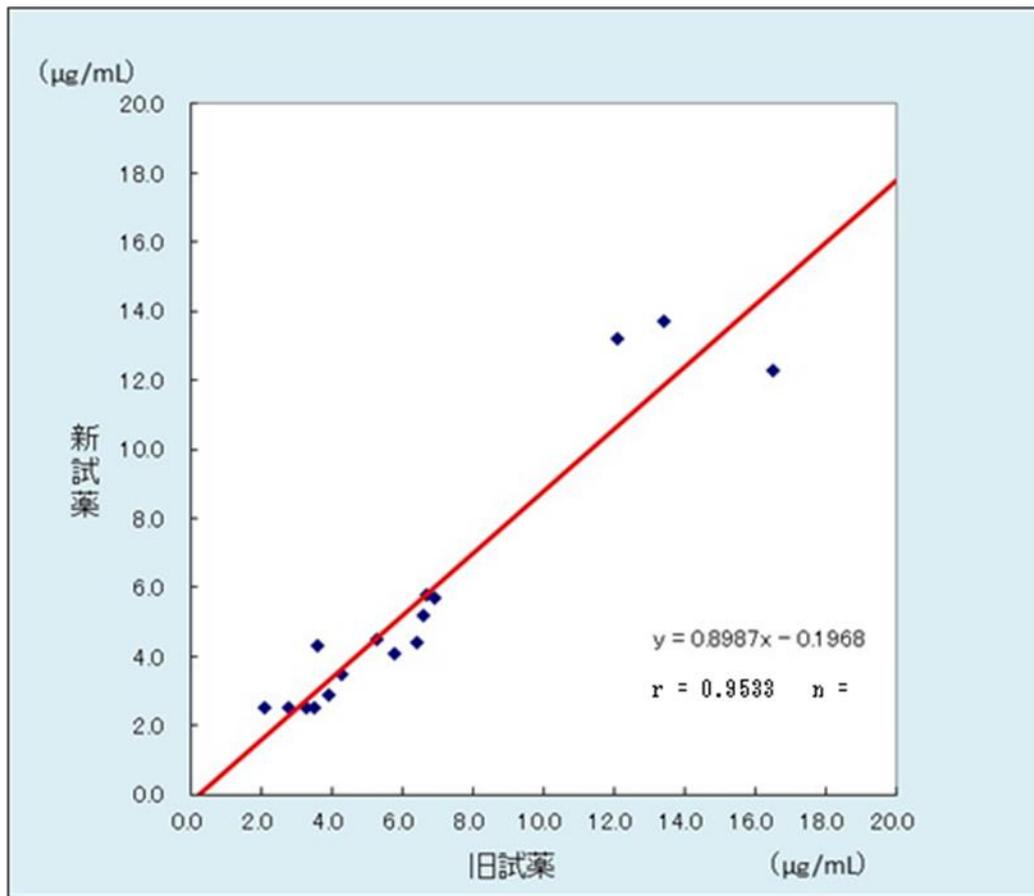

基準値 5.0 μg/mL 未満

新試薬 シスメックス リアスオート P-FDP  
 報告下限値 2.5 未満 μg/mL  
 報告上限値 120 以上 μg/mL