

FT-4 測定試薬変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、上記の検査項目につきまして、試薬供給会社から仕様変更の連絡がありましたのでご連絡致します。

詳細は下記をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

| 項目コード | 検査項目名 | 基準値 | 測定範囲 |
|-------|---------------|----------|--------------------|
| 0530 | 遊離サイロキシン(FT4) | 変更ございません | 0.25~8.00 ng/dL |

● 変更内容

バセドウ病ガイドラインにおきまして、バセドウ病の重症度の判定基準として治療前血清FT4レベル(参考例:重度 7ng/dL, 中等度 5~7ng/dL, 軽度 5ng/dL未満)と記載されている背景を受け、この度FT4 試薬におきまして、測定範囲を変更いたしました。つきましては、添付文書の変更内容を裏面の通りご案内申し上げます。(添付文書に記載の参考基準範囲に変更はございません。)

変更期日


- 2020年9月1日(火)受付日分より

相 関 性

FT-4 相 関

| 項目 | X | Y |
|------|------|------|
| FT-4 | 現試薬 | 新試薬 |
| No | | |
| 1 | 6.00 | 5.66 |
| 2 | 0.83 | 0.73 |
| 3 | 1.49 | 1.34 |
| 4 | 1.20 | 1.07 |
| 5 | 1.15 | 1.05 |
| 6 | 1.14 | 1.07 |
| 7 | 1.26 | 1.11 |
| 8 | 1.36 | 1.24 |
| 9 | 1.07 | 0.97 |
| 10 | 1.07 | 0.91 |
| 11 | 1.55 | 1.45 |
| 12 | 1.00 | 0.87 |
| 13 | 0.80 | 0.73 |
| 14 | 0.85 | 0.86 |
| 15 | 1.30 | 1.12 |
| 16 | 1.55 | 1.17 |
| 17 | 1.28 | 1.12 |
| 18 | 1.04 | 0.94 |
| 19 | 1.12 | 1.09 |
| 20 | 1.13 | 1.07 |
| 21 | 1.10 | 0.93 |
| 22 | 0.50 | 0.43 |
| 23 | 1.17 | 1.09 |
| 24 | 1.25 | 1.15 |
| 25 | 2.77 | 2.65 |
| 26 | 0.84 | 0.77 |
| 27 | 1.20 | 1.11 |
| 28 | 0.89 | 0.80 |
| 29 | 1.36 | 1.23 |
| 30 | 1.17 | 1.04 |
| 31 | 0.99 | 0.90 |
| 32 | 0.69 | 0.63 |
| 33 | 0.73 | 0.68 |
| 34 | 1.38 | 1.26 |
| 35 | 1.72 | 1.26 |
| 36 | 2.12 | 1.96 |

現:6 ↑

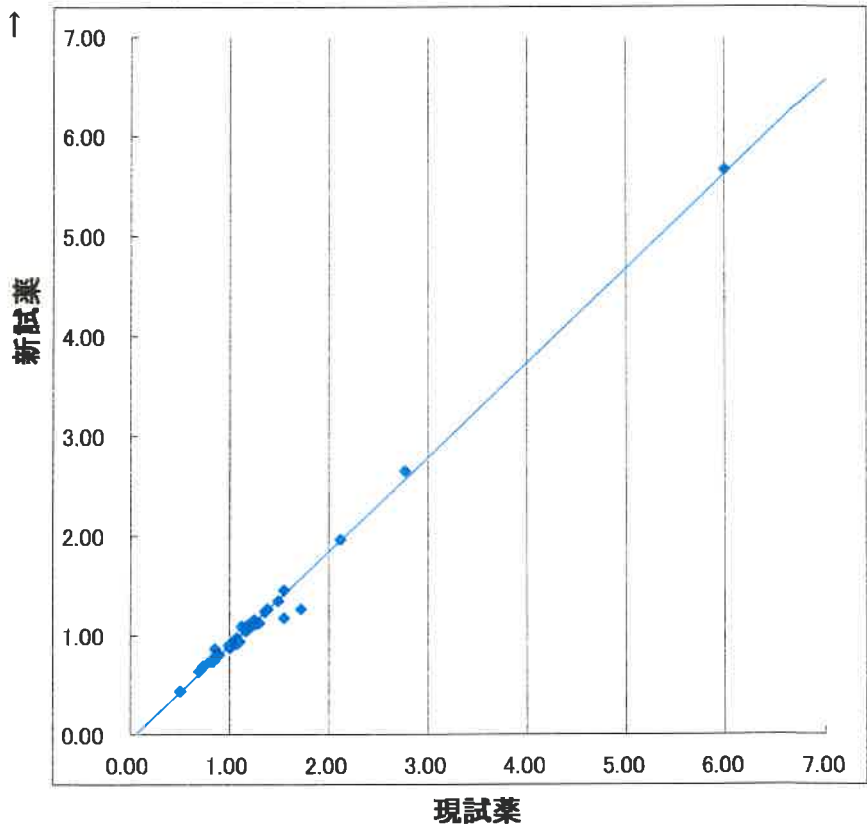

$n = 36$
 $X \text{ mean} = 1.34$
 $Y \text{ mean} = 1.21$
 $y = 0.945x - 0.0546$
 $r = 0.9958$