

「CRP(高感度)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、下記の検査項目につきまして、別メーカーが販売するラテックス凝集比濁法試薬に変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

●2689 CRP(高感度)

変更内容	新	旧
検査方法	LA(ラテックス凝集比濁法)	ネフェロメトリー法
検体量/保存方法	血清 0.4mL/冷蔵[容器番号:01番]	同左
基準値	(設定せず)	同左
報告下限	0.004 mg/dL 未満	同左
報告上限	999.999 mg/dL 以上	0.500 mg/dL 以上
報告桁数	小数3位、有効6桁	小数3位、有効3桁
所要日数	3～4日	同左
検査実施料/判断料	16点/免疫学的検査判断料	同左
検査委託先	株式会社 LSIメディエンス	同左


変更期日

- 令和2年9月30日(水)受付日分より


CRP(高感度)

新旧二法の相関

[全域]

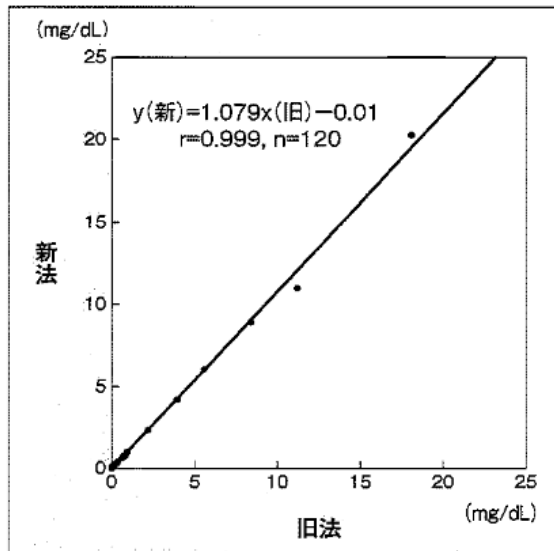

[低値域]

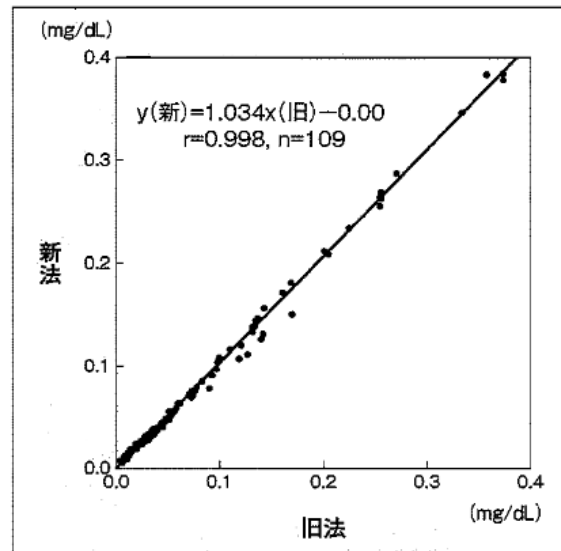

(LSI メディエンス検討データ)