

## 「セレン(Se)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、標記項目につきまして、検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 対象項目/変更内容

#### ● 2916 セレン(Se)

変更内容	新	旧	案内書 掲載頁
検査方法	ICP-MS	原子吸光法	P20
基準値	10.0~16.0 µg/dL	10.6~17.4 µg/dL	
所用日数	4~5日	6~11日	

### 変更期日

#### ● 令和3年9月30日(木)受付日分より

## ●セレン(Se)


---

検査方法を原子吸光法からICP-MS法に変更し、所要日数を短縮します。なお、新基準値は、LSIメディエンス従業員実測値にて設定した値です。

## LSI メディエンス検討データ

---

### ●相関図

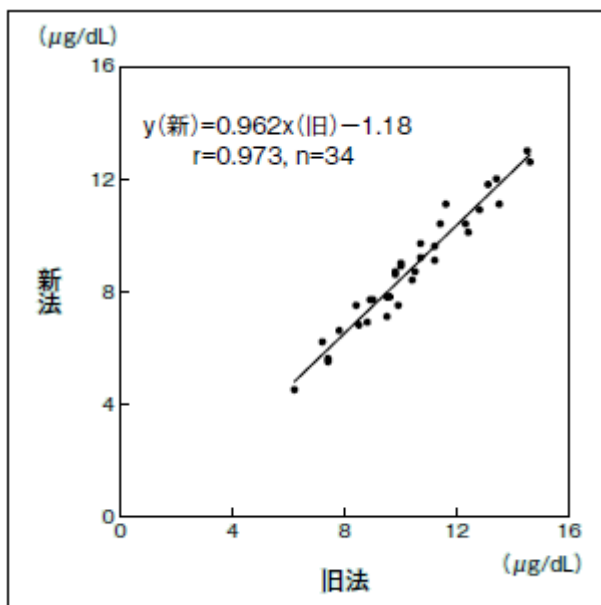

(LSI メディエンス検討データ)