

「L-ドーパ」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、標記項目につきまして、検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

● 842 L-ドーパ

| 変更内容 | 新 | 旧 | 案内書 掲載頁 |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 検査方法 | LC-MS/MS | HPLC | 札臨 |
| 備考 | 血清は検査不可。 検体採取後、速やかに提出できない場合は、 -70°C 以下で保存してください。 | ヘパリン血漿は検査不可。 | P33 |

変更期日


● 令和3年9月30日(木)受付日分より

●L-ドーパ

検査方法をHPLC法からLC-MS/MS法に変更いたします。なお、新旧二法の相関は良好です。

LSI メディエンス検討データ

●相関図

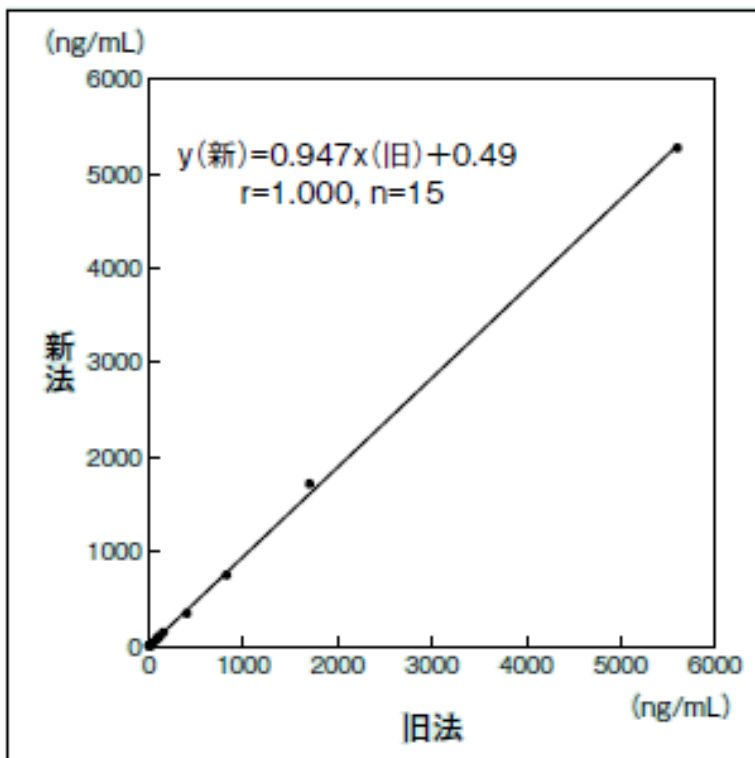

(LSI メディエンス検討データ)

●参考文献

Martins HF, et al. : Quimica Nova **36**(1) :171–176, 2013.