

「SP-D(サーファクタントプロテイン-D)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、標記項目につきまして、検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

● 1765 SP-D(サーファクタントプロテイン-D)

変更内容	新	旧	備考
検査方法	CLEIA	EIA	測定試薬の変更
検体量(mL)	血清 0.5 mL	血清 0.3 mL	
所用日数	3~4日	4~6日	
報告下限	15.0 ng/mL未満	17.2 ng/mL以下	
報告上限	10,000 ng/mL以上	9,990,000 ng/mL以上	

※基準値、単位に変更はございません。

変更期日


● 令和3年9月30日(木)受付日分より

●SP-D(サーファクタントプロテイン-D)

所要日数を短縮可能な同一メーカーが販売するCLEIA法試薬に変更いたします。なお、新旧二法の相関は良好であり、基準値に変更はございません。

LSI メディエンス検討データ

●相関図

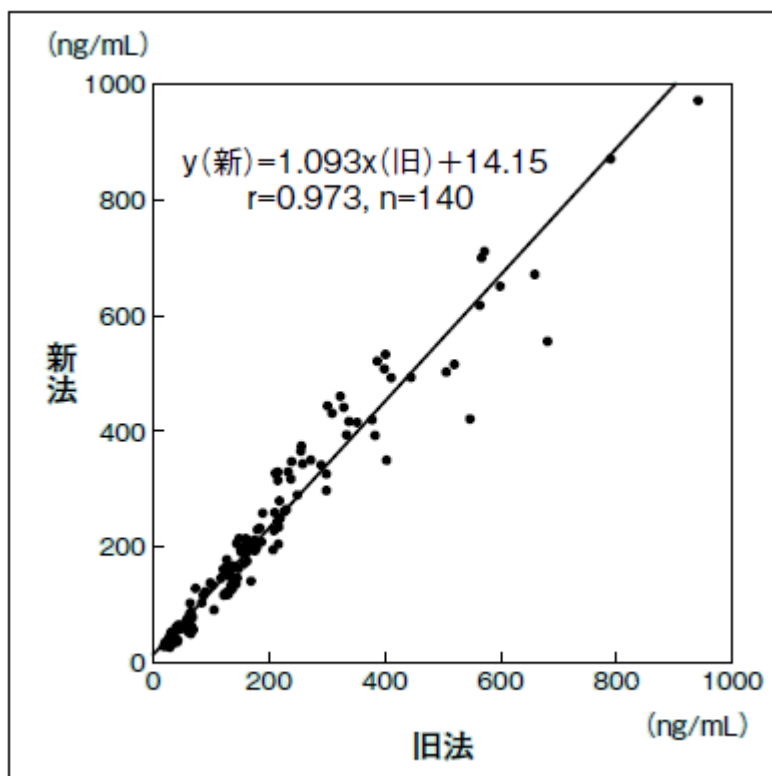

(LSI メディエンス検討データ)

●参考文献

土居耕介, 他: 医学と薬学 78(3):261~267, 2021.