

「血清アミロイド A 蛋白(SAA)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さてこの度、標記項目につきまして
検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

● 1761 血清アミロイド A 蛋白(SAA)

| 変更内容 | 新 | 旧 | 備考 |
|-------------|---------------------|------------------|---------------|
| 検査方法 | LA(ラテックス凝集比濁法) | LA(ラテックス凝集比濁法) | 現行試薬の販売 中止 |
| 基準値 (単位) | 3 以下 (mg/L) | 8.0 以下 (μg/mL) | |
| 報告単位 | mg/L | μg/mL | |
| 報告下限 | 2.0 未満 (mg/L) | 2.5 未満 (μg/mL) | |
| 報告上限 | 9,999,999 以上 (mg/L) | 99,999.9 (μg/mL) | |
| 報告桁数 | 小数1位、有効7桁 | 小数1位 | |

変更期日

● 令和4年3月31日(木)受付日分より


●血清アミロイド A 蛋白(SAA)

現行試薬の販売中止に伴い、同一メーカーのLA(ラテックス凝集比濁法)試薬に変更いたします。新試薬は、校正用基準物質にWHO標準品を用いた国際標準化に対応した試薬です。なお、新基準値は測定試薬の添付文書記載値です。


LSI メディエンス検討データ

●相関図

[全域]

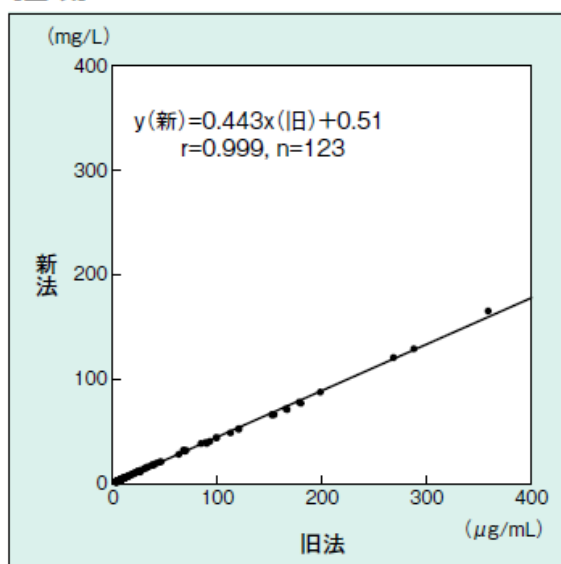

[低値域]

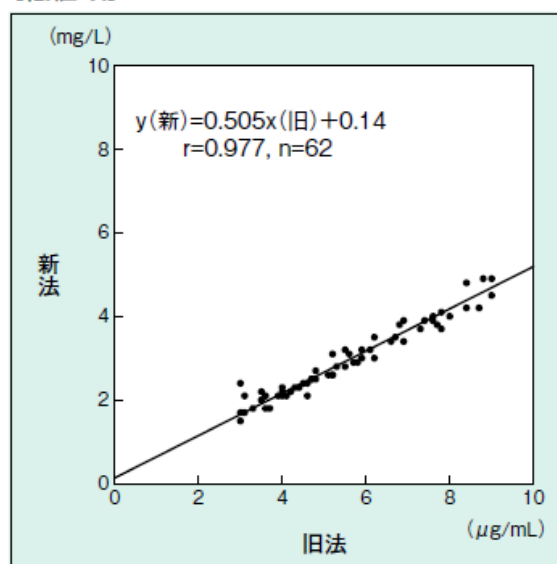

※μg/mL=mg/Lです。

●参考文献

旭由香里, 他: 医学と薬学 78(2):175-181, 2021.