

「フォン・ウィルブランド因子活性」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、標記項目の測定委託先(株式会社エスアールエル セントラルラボラトリー)より、検査内容を変更する旨の連絡を受けましたのでご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧	備考 (検査案内掲載頁)
1275	フォン・ウィルブランド因子活性 (リストセチンコファクター)	検査方法	ラテックス免疫比濁法	固定血小板凝集法	測定試薬変更に伴う、検査方法、基準値、報告範囲の変更 (※詳細については、裏面をご参照ください) (P.89)
		基準値 (単位)	非O型 : 61~240 O型 : 48~202 (%)	60~170 (%)	
		報告範囲	7 未満、7~480、481 以上	6 以下、7~99900000	
		JLAC10コード	2B480-0000-022-062	掲載なし	

※「総合検査のご案内 2026年度版」では、変更後の内容を掲載しております。

変更期日

- 令和8年7月2日(木)受付日分より




●フォン・ウィルブランド因子活性(リストセチンコファクター)

感受性が改善される測定試薬に変更します。
これに伴い、検査方法、基準値、報告範囲が変更となります。

エスアールエル検討データ

●相関図

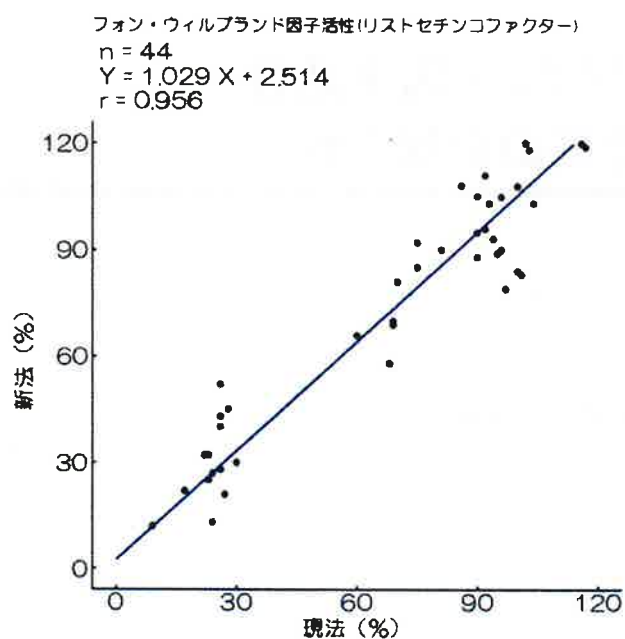

●参考文献

測定法: Stufano F. et al: Haemophilia 20(1):147~153, 2014.

「フォン・ウィルブランド因子抗原定量」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、標記項目の測定委託先(株式会社エスアールエル セントラルラボラトリー)より、検査内容を変更する旨の連絡を受けましたのでご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧	備考 (検査案内掲載頁)
1261	フォン・ウィルブランド因子 抗原定量	検査方法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集反応	測定試薬変更に 伴う、検査方法 (方法名)、基準 値、報告範囲の 変更 (※詳細につい ては、裏面をご参照 ください) (P.89)
		基準値 (単位)	非O型 : 66~176 O型 : 42~141 (%)	50~155 (%)	
		報告範囲	9 未満、9~999、1000 以上	5 以下、6~99900000	

※「総合検査のご案内 2026年度版」では、変更後の内容を掲載しております。

変更期日

- 令和8年7月2日(木)受付日分より




●フォン・ウィルブランド因子抗原定量

試薬販売終了のため測定試薬を変更します。
これに伴い、検査方法名、基準値、報告範囲が変更となります。

エスアールエル検討データ

●相関図

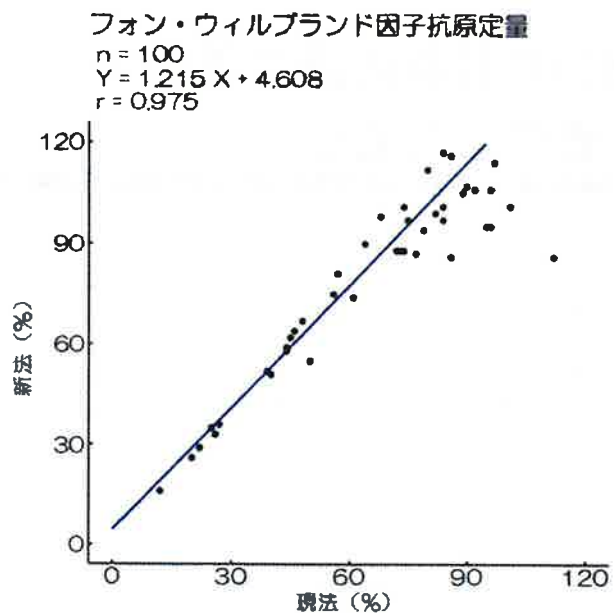

●参考文献

測定法: Stufano F. et al: Haemophilia 20(1): 147~153, 2014.